

お客さまへ

本挿入用紙(以下、本紙)は、HR-706(以下、本器)について説明したものです。

お手元にある HR-706(打点式) 取扱説明書(No.HR71J15)の記載内容に変更がございました。

変更箇所を下記に赤字で示しております。

本器を使用する時は、HR-706(打点式) 取扱説明書と本紙を併せてお読みください。

P.6 1.1 付属品の確認 表内


No.	名称	形番	個数	記
2	リボンカセット	EPSR024C000001A	1	※旧品 WPSR188A000001A とは リボン配色が異なります。

P.100 9.3 消耗品の交換 表内

項	品名	品番	交換周期	備考	使用個数
2	リボンカセット	EPSR024C000001A	3 か月	記録紙速度 20mm/h の場合	1

[注 意]

- ① リボンカセットはデータ等の印字を頻繁に行った場合、交換周期前でも記録が薄くなります。早めに交換してください。
- ② リボンカセットは購入後 1 年以内に使用してください。インク蒸発により、経時的に薄くなります。
- ③ リボンカセットには旧品 WPSR188A000001A があり、形状は同じため取り付けは可能ですが、配色が異なります。
ソフトウェアバージョンが「5.00」以降の場合は EPSR024C000001A を使用してください。
ソフトウェアバージョンはセットアップモード移行時に表示されます。(7.1 項 41 頁参照)
リボンカセットの形名は箱側面に記載されていますので交換前に確認してください。

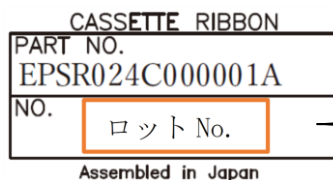

EPSR024C000001A : 5.00以降
WPSR188A000001A : 4.03以前

P.111 11.2.1 測定レンジ

端子台基準接点補償精度は下記の通りです。

- ・ B, R, S, PR40-20, Au-Fe : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ・ K, E, J, T, C, N, PL II, U, L : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

また、周囲温度の変化に対する変動は下記の通りです。

- ・ 温度変化に対する変動 : 表示精度定格 $\times 0.8 / 10^{\circ}\text{C}$ 以内

基準動作条件におけるデジタル表示精度定格を表 11.2 に示します。